

- P77 (誤) 附属書 5C RDM の洗浄消毒条件チェックリスト
 (正) 附属書 5C RMD の洗浄消毒条件チェックリスト

- P108 表 8-5
 (誤)

表 8-5 抽出された溶液の単位あたり残留蛋白質総量計算例

総抽出量 (mL)	検出された残留蛋白質の濃度 (µg/mL)	RMD の抽出結果から導き出される残留蛋白質量 (µg)
2	100	200
3	67	201
4	50	200
5	40	200
2	50	102
3	34	100
4	25	100
5	20	100

- (正)

表 8-5 抽出された溶液の単位あたり残留蛋白質総量計算例

総抽出量 (mL)	検出された残留蛋白質の濃度 (µg/mL)	RMD の抽出結果から導き出される残留蛋白質量 (µg)
2	100	200
3	67	200
4	50	200
5	40	200
2	50	100
3	33	100
4	25	100
5	20	100

- P128 1 行目 (誤) $SAL \leq 10^{-6}$
 (正) $SAL \leq 10^{-6}$

- 8 行目 (誤) 製品に設置した全て BI が陰性であることを確認する。
 (正) 製品に設置した全ての BI が陰性であることを確認する。

P145 10.8.2 滅菌器の保全

10.8.2 適格性確認

P147 表 10-15 (誤) エチレンクロルヒドリン (GECH)

(正) エチレンクロルヒドリン (ECH)

P229 図 17-1

(誤)

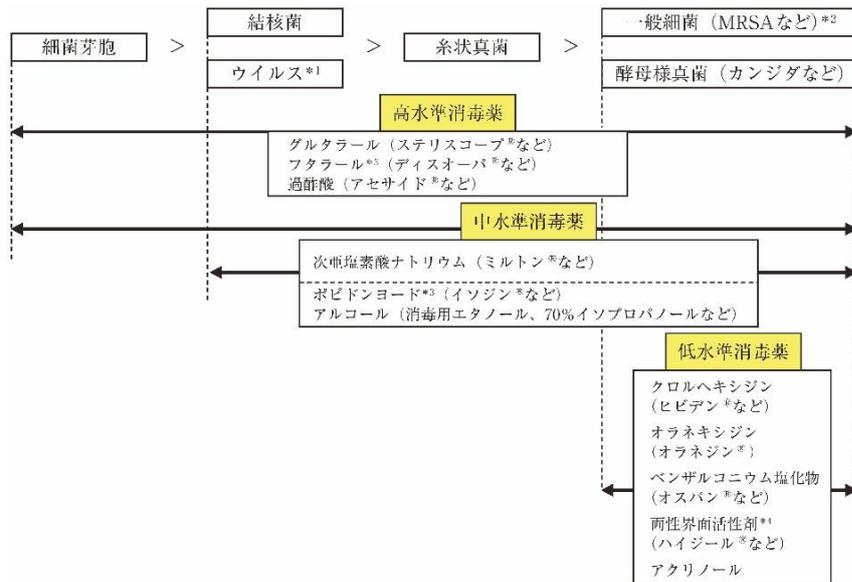


図17-1 微生物の消毒薬抵抗性の強さ、および消毒薬の抗菌スペクトル

(正)

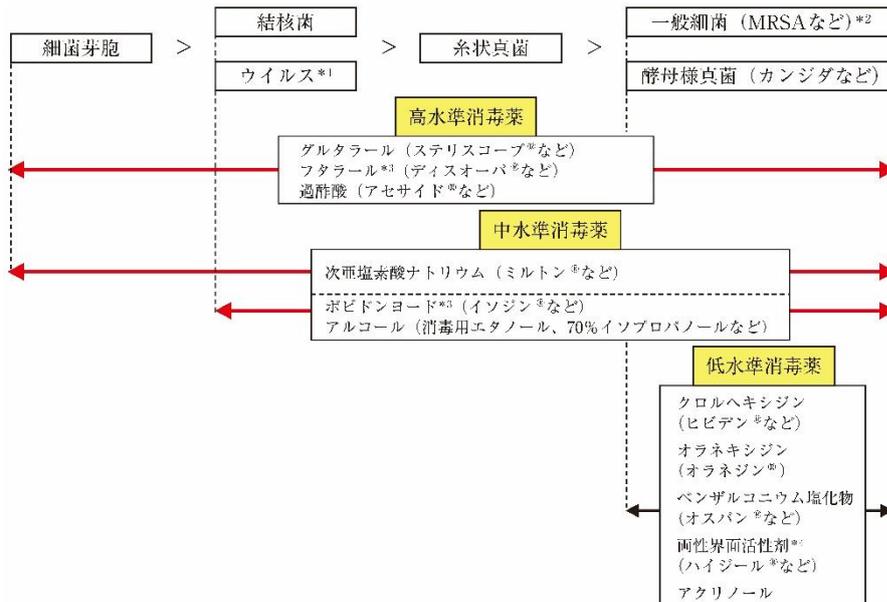


図 17-1 微生物の消毒薬抵抗性の強さ、および消毒薬の抗菌スペクトル