

P26 図 1-10、図 1-11 縦軸の名称

(誤) 菌数の対数値

(正) 菌数

P77 (誤) 附属書 5C RDM の洗浄消毒条件チェックリスト

(正) 附属書 5C RMD の洗浄消毒条件チェックリスト

P108 表 8-5

(誤)

表 8-5 抽出された溶液の単位あたり残留蛋白質総量計算例

総抽出量 (mL)	検出された残留蛋白質の濃度 (µg/mL)	RMD の抽出結果から導き出される残留蛋白質量 (µg)
2	100	200
3	67	201
4	50	200
5	40	200
2	50	102
3	34	100
4	25	100
5	20	100

(正)

表 8-5 抽出された溶液の単位あたり残留蛋白質総量計算例

総抽出量 (mL)	検出された残留蛋白質の濃度 (µg/mL)	RMD の抽出結果から導き出される残留蛋白質量 (µg)
2	100	200
3	67	200
4	50	200
5	40	200
2	50	100
3	33	100
4	25	100
5	20	100

P126 表 9-6 (誤) 人工骨髄セット

(正) 人工骨頭セット

P128 1 行目 (誤) $SAL \leq 10^{-6}$

(正) $SAL \leq 10^{-6}$

3～4 行目 (誤) 検証する 5)。

3～4 行目 (正) 検証する⁵⁾。

8 行目 (誤) 製品に設置した全て BI が陰性であることを確認する。

(正) 製品に設置した全ての BI が陰性であることを確認する。

P145 10.8.2 滅菌器の保全

10.8.2 適格性確認

P147 表 10-15 (誤) エチレンクロルヒドリン (GECH)

(正) エチレンクロルヒドリン (ECH)

P229 図 17-1

(誤)

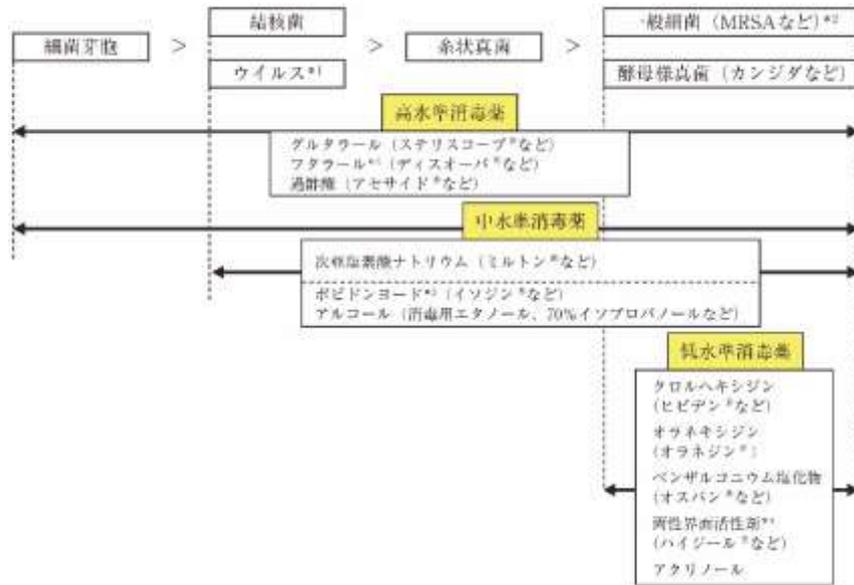


図17-1 微生物の消毒薬抵抗性の強さ、および消毒薬の抗菌スペクトル

(正)

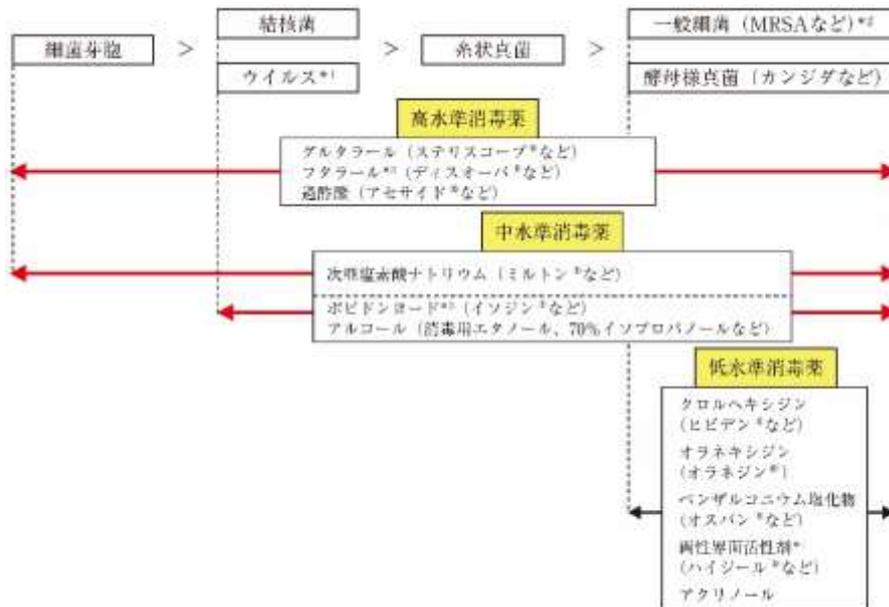


図 17-1 微生物の消毒薬抵抗性の強さ、および消毒薬の抗菌スペクトル